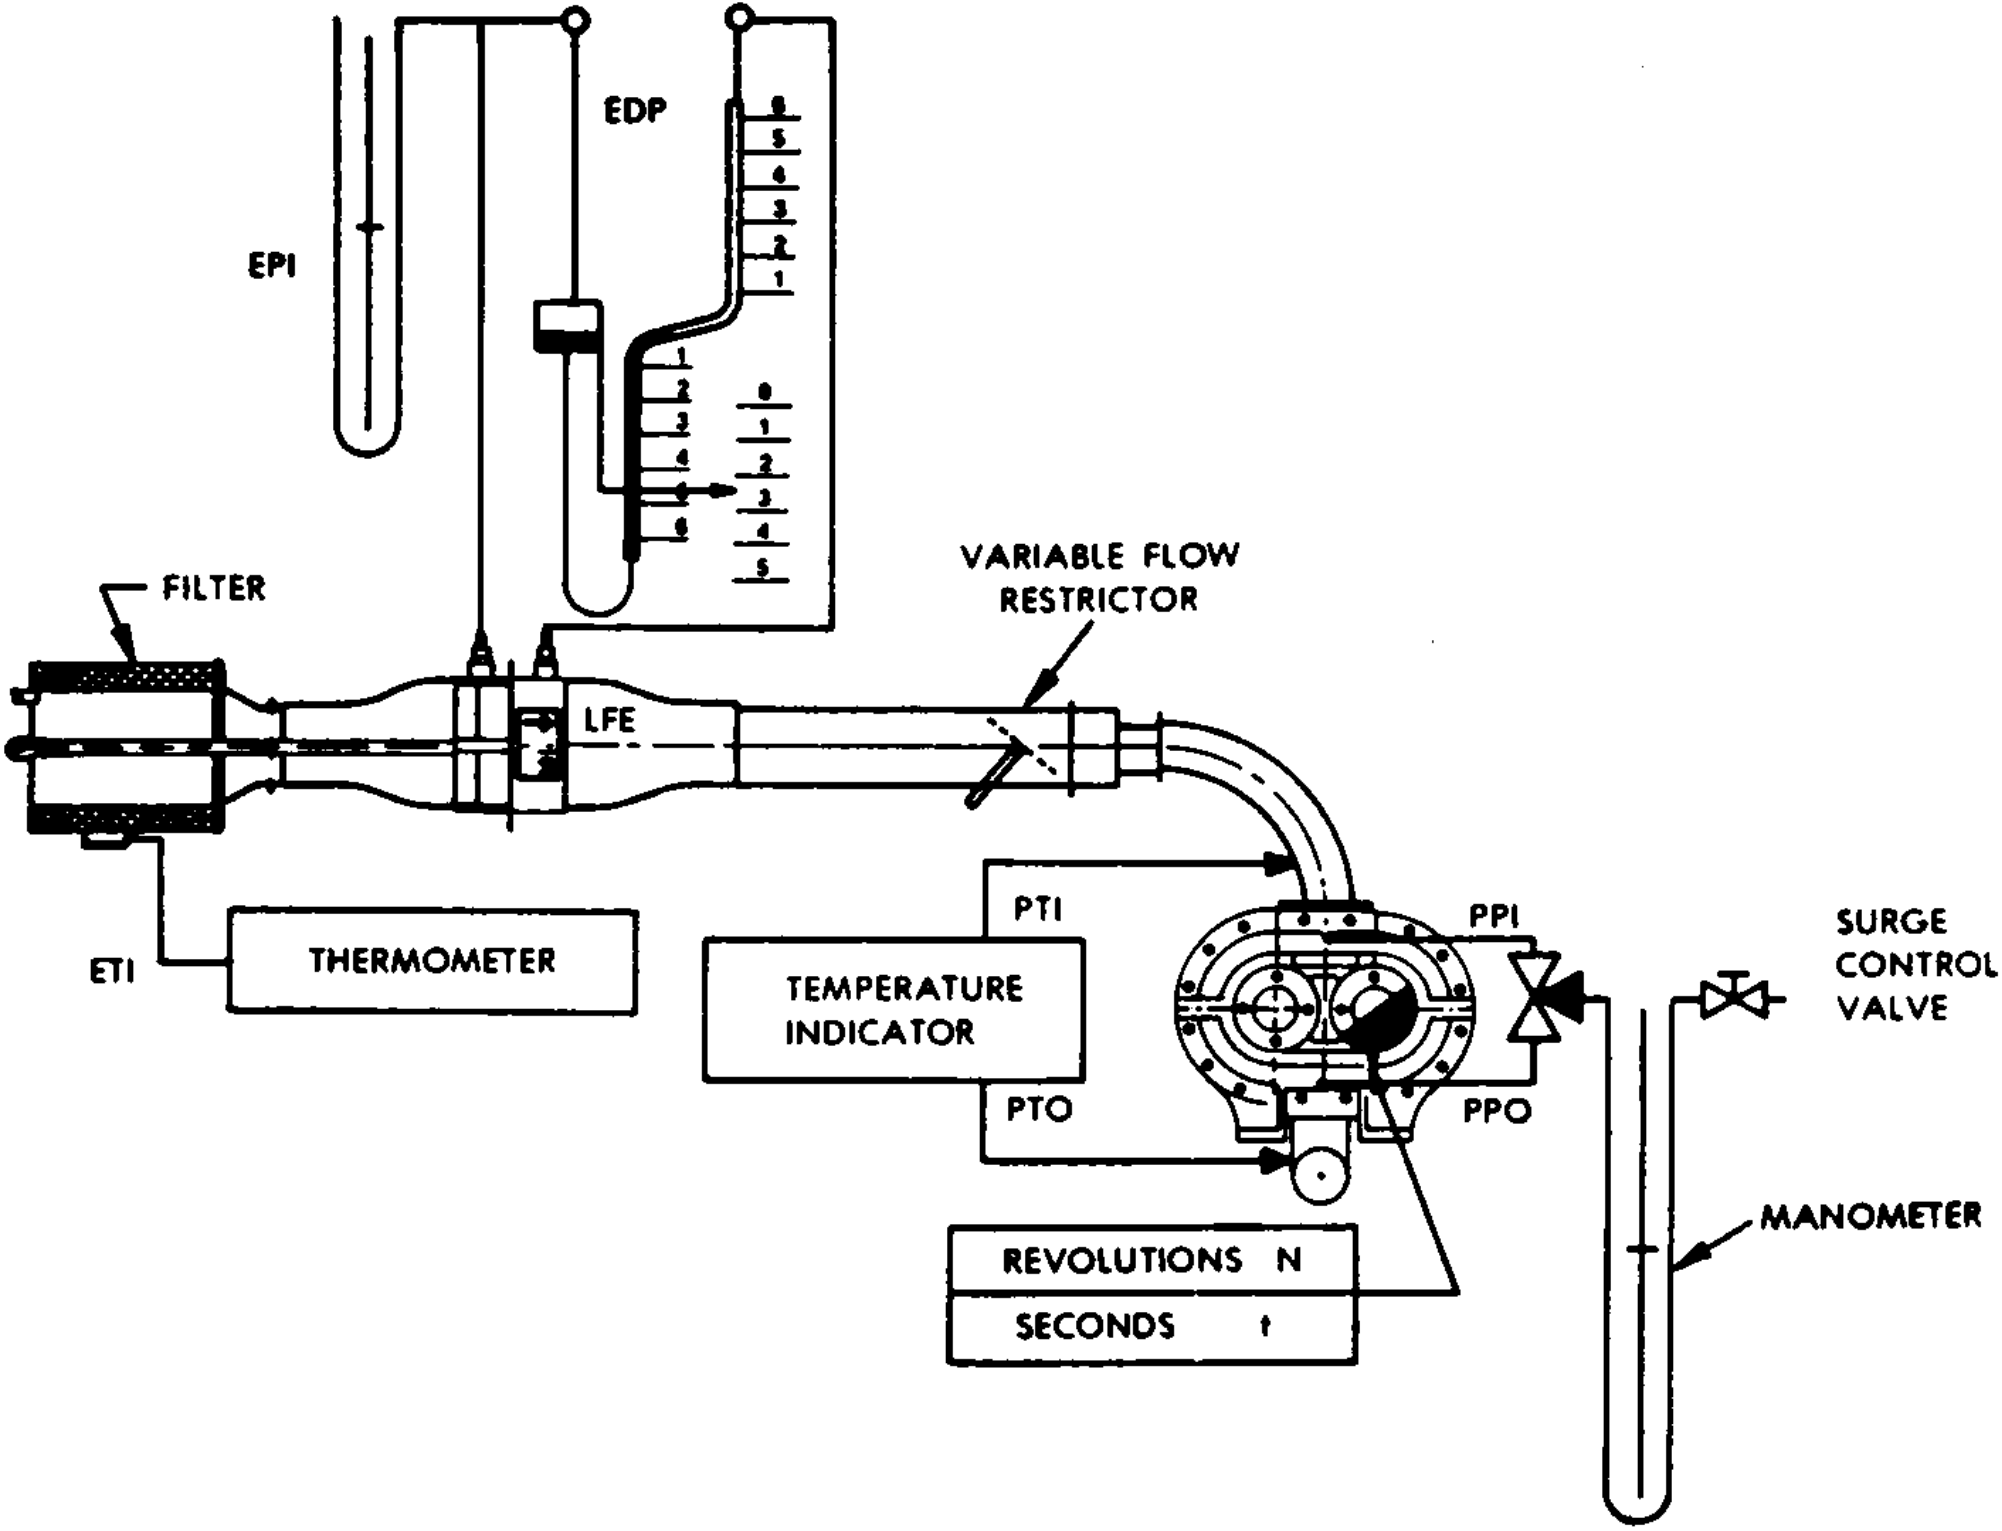

F78-5 —PDP-CVS CALIBRATION CONFIGURATION